



INNOVARIO® DESCRIPTION

L'unité **Innovario®** de **BLOCK OPTIC** se déplace continuellement jusqu'à la hauteur d'examen requise au moyen d'un moteur électrique et offre donc le poste de travail ergonomique idéal. Quelle que soit sa taille, le patient peut être ainsi examiné de manière optimale.

Grâce au système spécial d'encliquetage, tous les modèles de sièges patient peuvent être déplacés par roulement dans toutes les directions possibles.

Le système de déplacement sans fil du siège patient permet de placer les patients en fauteuil roulant devant l'unité d'examen sans aucun effort.

L'unité d'examen ophtalmologique **Innovario®** de **BLOCK OPTIC** est l'alliance parfaite entre une technique moderne, une fonctionnalité ergonomique et un design attractif.

Son principe de construction modulaire permet une configuration individuelle, tant sur le plan des équipements techniques que sur celui des finitions de couleur et de texture.



NOTRE ENGAGEMENT – LA DURABILITÉ

Nos unités d'examen sont fabriquées à partir de matériaux de grande longévité. Nous reconditionnons des unités d'examen d'occasion et leur offrons une seconde vie.




③ Siège Neo®, CaraT®, Vito® ou Zac®




Port USB pour les travaux d'inspection


DÉTAILS

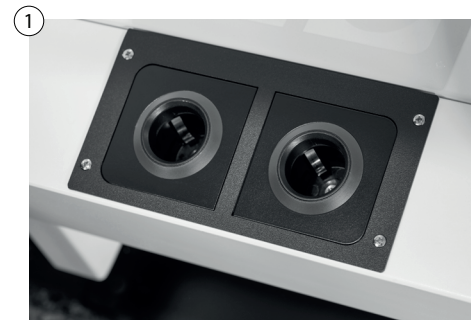

① Socle chargeur pour instruments ophtalmologiques portatifs

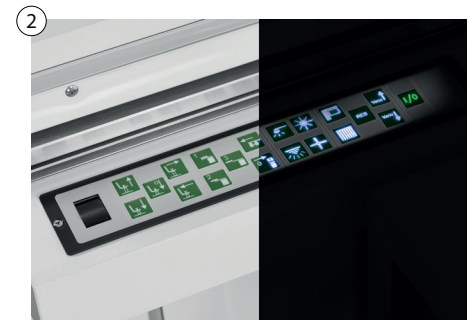

② Clavier souple à membrane antibactérien, avec ou sans éclairage

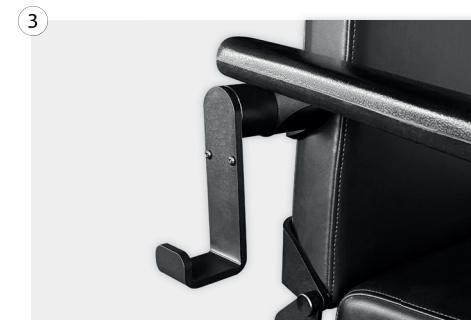

③ Porte-sac



④ Bras de phoroptère à inclinaison physiologique avec ou sans réglage en hauteur électromotorisé



⑤ Table télescopique pour une, deux ou trois positions, avec translation manuelle ou électromotorisée



⑥ Unité avec réglage en hauteur continu (environ 71 - 96 cm)



Colonne multifonctionnelle avec ou sans adaptateur pour projecteur



Réglage en hauteur continu du siège patient




Socle ondulé pour 1-3 instruments portatifs

Liste des options disponibles en versions main droite et main gauche:


- Réglage en hauteur continu (environ 71 - 96 cm) pour un travail ergonomique
- Table télescopique pour une, deux ou trois positions, avec translation manuelle ou électromotorisée
- Rail de phoroptère manuel ou électromotorisé
- Bras de phoroptère à inclinaison physiologique avec ou sans dispositif d'inclinaison en continu
- Bras de phoroptère à inclinaison physiologique avec ou sans réglage en hauteur électromotorisé
- Bras de phoroptère à inclinaison physiologique avec ou sans lampe de lecture
- Colonne multifonctionnelle avec ou sans support pour écran plat
- Colonne multifonctionnelle avec ou sans lampe de travail
- Colonne multifonctionnelle avec ou sans projecteur
- Système électronique PLD ou Easy (ou système de commande électronique individuel en alternative)
- Clavier souple à membrane antibactérien, avec ou sans éclairage
- Eclairage ambiant LED automatique avec système Dali
- Commande de stores
- Socle ondulé pour instruments portatifs
- Socle chargeur pour instruments portatifs
- Vernissage antibactérien de couleur personnalisée (toutes couleurs RAL)
- Revêtement plastique personnalisé
- Plaquage bois personnalisé
- Bureau avec ou sans réglage en hauteur électromotorisé
- Accessible aux fauteuils roulants grâce à l'option de déplacement du siège
- Elargissement de la table à instruments pour toutes les positions
- Extension de la table à instruments
- Personnalisations et réalisations sur mesure répondant aux besoins spécifiques du client et complémentaires au modèle de série

DONNÉES TECHNIQUES

Innovario®
Version main droite avec système
d'encliquetage spécial
Plan d'une unité à 2 positions

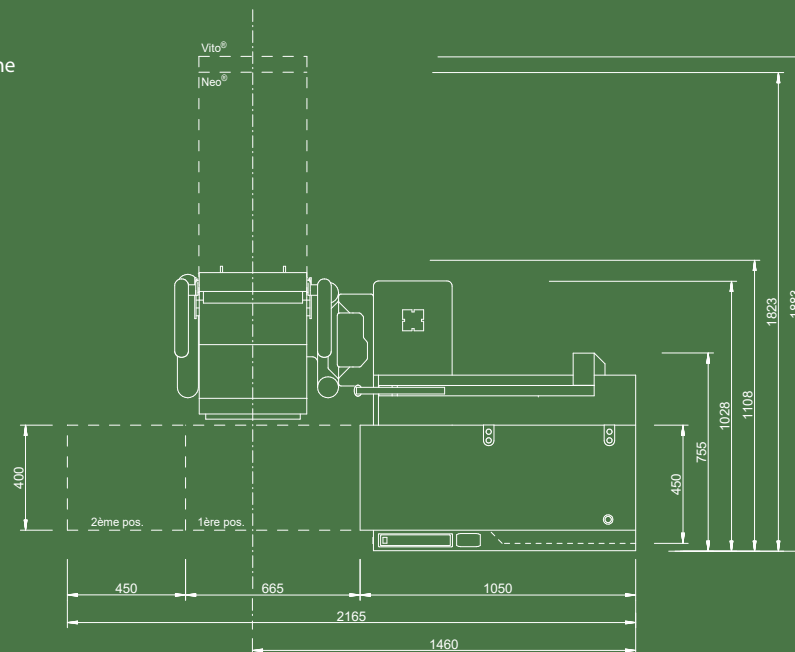

Innovario®
Version main droite avec système
d'encliquetage spécial
Plan d'une unité à 3 positions

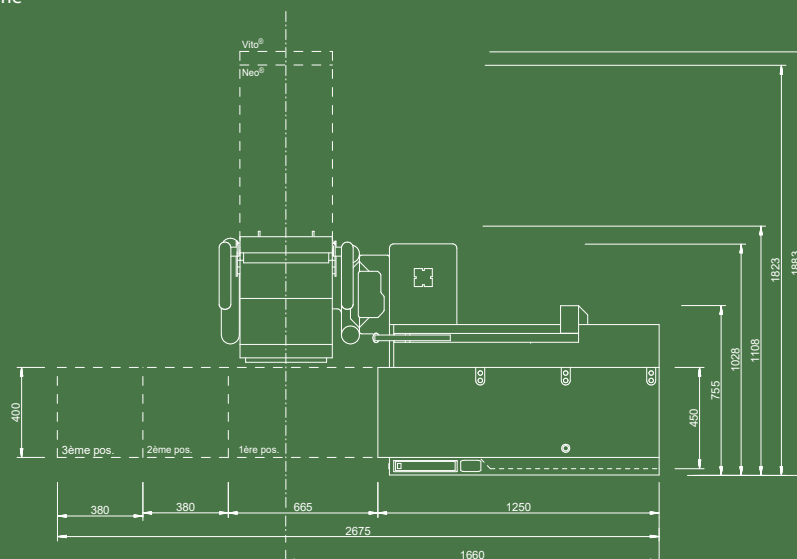

Longueur	1028 mm
Profondeur	2ème pos.: 2165 mm 3ème pos.: 2660 mm
Hauteur normée	860 mm
Réglage en hauteur / option	710 - 960 mm
Poids	env. 250 – 330 kg
Tension d'entrée nominale	230 V, 50/60 Hz
Exigences de protection	EMVG / DIN EN 60601-1-2
Classe de protection	MPG 1
Type de protection	IP 20
Consommation électrique	env. 1400 VA

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

Sous réserve de modifications techniques 04 / 25