



Handbuch Instrumenten- und Gerätetisch *Exclusiv*

Handbuch ab 2012

Stand: Juni 2012

Technische Änderungen vorbehalten!

Block Optic Ltd.

Semerteichstr. 60

D- 44141 Dortmund

Tel.: +49(0) 231 / 10 87 78 50

Fax: +49(0) 231 / 17 63 065

email: info@block-optic.com

Inhaltsverzeichnis

1 Angaben zum Gerät.....	3
2 Wichtige Hinweise für Aufstellung, Montage, Reparatur und Instandsetzung.....	6
3 Verpackung.....	7
4 Gerätebeschreibung und Systemkomponenten.....	8
5 Bedienung und Sicherheitsmaßnahmen.....	9
6 Wartung, Reinigung, Pflege und Entsorgung.....	10
7 Technische Daten.....	12
8 EG-Konformitätserklärung.....	14

Vielen Dank für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses Instrumenten- und Gerätetischs "*Exclusiv*" entgegengebracht haben. Mit dem *Exclusiv* haben Sie sich für ein modernes, ausgereiftes Produkt entschieden, das nach strengen Qualitätskriterien gefertigt und geprüft wurde. Fortwährende Forschung und Entwicklung können Veränderungen in Ausführung und Lieferumfang verursachen. Die Abbildungen in dieser Gebrauchsanweisung können deswegen in Einzelfällen von dem gelieferten Gerät geringfügig abweichen. Abgebildet ist die rechtsseitige Ausführung. Bei der linksseitigen Ausführung ist die Anordnung der Einheit entsprechend spiegelverkehrt. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen zu Ihrem Gerät wünschen, rufen Sie uns an, faxen Sie uns oder schreiben Sie uns eine e-Mail. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne zur Verfügung.

1 Angaben zum Gerät

Gerätebezeichnung: Instrumenten- und Gerätetisch "Exclusiv"

Hersteller: Block Optic Ltd.
Semerteichstr. 60
44141 Dortmund
Deutschland

Verwendungszweck/

Anwendungsgebiet: Der *Exclusiv* ist ein universeller Instrumenten- und Gerätetisch zur Aufnahme ophthalmologischer und augenoptischer Geräten. Der Einsatz des Instrumenten- und Gerätetisch *Exclusiv* erfolgt in der Augenoptik und Augenheilkunde.

Sachwidrige

Verwendung:

Ein anderer Einsatz als der Angegebene ist nicht zulässig. Bei sachwidriger Verwendung können unvorhersehbare Gefahren auftreten. Nach einem Dauerbetrieb der Höhenverstellung von 1,5 Minuten muss eine Abkühlzeit von mindestens 8,5 Minuten eingehalten werden. Wird die Höhenverstellung länger als 1,5 Minuten fortwährend betätigt, kann dies zu einem Defekt in der Höhenverstellung führen. Im normalen Betriebsablauf wird die dabei notwendige kurze Abkühlzeit automatisch eingehalten.

Lieferumfang:

Der *Exclusiv* ist in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten lieferbar. Der jeweilige Lieferumfang ist im Lieferschein detailliert aufgelistet.

Sicherheitshinweise:

a) Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und machen Sie sich mit allen Funktionen vertraut, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten.

b) Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen an dem Instrumenten- und Gerätetisch vor, da hierdurch die Sicherheit beeinträchtigt werden kann und alle Garantieansprüche erlöschen.

c) Das Gerät ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.

d) Verwenden Sie den Instrumenten- und Gerätetisch nicht, wenn dieser sichtbare Beschädigungen aufweist. Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen. Wenden Sie sich in diesem Fall

bitte an die die Firma Block Optic oder an einen von der Fa. Block Optic autorisierten Servicetechniker.

e) Betreiben Sie den *Exclusiv* nur mit Originalzubehöerteilen.

f) Wenn der Instrumenten- und Gerätetisch längere Zeit nicht benutzt werden soll, schalten Sie den beleuchteten Hauptschalter aus. Es empfiehlt sich, Staubschutzhüllen über die auf den Instrumenten- und Gerätetisch montierten Geräte zu legen.

g) Zusatzausrüstungen, die an die elektrische Versorgung des Gerätes angeschlossen werden, müssen nachweisbar ihren entsprechenden DIN EN bzw. IEC-Spezifikationen genügen. Weiterhin müssen alle Konfigurationen die Anforderungen der Systemnorm DIN EN 60601- 1- 1 (IEC 601- 1) und deren Änderungen erfüllen. Die Kopplung des Gerätes mit nichtmedizinischen Geräten (z.B. Datenverarbeitungsgeräte) zu einem medizinisch-elektrischen System darf nicht zu einem Sicherheitsgrad für den Patienten, Anwender und die Umgebung führen, der unter dem der DIN EN 60601- 1 (IEC 601- 1) und deren Änderungen liegt. Wenn durch die Kopplung die zulässigen Werte für Ableitströme überschritten werden, müssen Schutzmaßnahmen entsprechend der Systemnorm DIN EN 60601- 1- 1 (IEC 601- 1- 1) und deren Änderungen vorhanden sein. Ein System darf nach der Installation oder späteren Änderung keine Gefährdung für den Patienten, den Anwender oder die Umgebung verursachen.

**Hersteller
Verantwortung:**

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Die Fa. Block Optic betrachtet sich nur dann für die Auswirkungen auf die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des Gerätes als verantwortlich, wenn:

- Montage, Erweiterungen, Neueinstellungen, Änderungen oder Reparaturen durch Fa. Block Optic ermächtigte Personen ausgeführt werden,
- die elektrische Installation des betreffenden Raumes den Anforderungen der VDE 0100-710 entspricht und
- das Gerät in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung verwendet wird.

Betreiber**Verantwortung:**

Der Betreiber ist unter anderem verantwortlich für:

- die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften sowie der Verordnung über das Errichten, Betreiben und Anwenden von Medizinprodukten (Medizinprodukte - Betreiberverordnung MPBetreibV),
- den Betrieb,
- die Wartung,
- den ordnungsgemäßen und sicheren Zustand des Produkts und
- die Aufbewahrung der Gebrauchsanweisung und technischer Unterlagen am Einsatzort.

Garantie:

Es gelten grundsätzlich die "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" der Firma Block Optic.

Textliche**Hervorhebungen:**

Wichtige Textpassagen sind in der Gebrauchsanweisung durch Hervorhebungen und Schlüsselwörter besonders gekennzeichnet. In der vorliegenden Gebrauchsanweisung werden folgende Hervorhebungen verwendet:

Vorsicht!

Weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin. Beachten Sie die so gekennzeichneten Vorsichtsmaßnahmen, um die Gefährdung von Personen oder Schäden an Sachgütern zu vermeiden.

Wichtig!

Kennzeichnet wichtige Informationen. Lesen Sie diese Informationen, um den hohen Sicherheits- und Funktionsstandard des Gerätes zu erhalten.

Hinweis!

Kennzeichnet Informationen zum korrekten Gebrauch. Bitte lesen Sie diese Informationen, um eine Fehlbedienung zu vermeiden.

2 Wichtige Hinweise für Aufstellung, Montage, Reparatur und Instandsetzung

Die Aufstellung und Montage des Instrumenten- und Gerätetischs *Exclusiv* dürfen ausschließlich durch die Firma Block Optic oder durch die Firma Block Optic autorisiertes und unterwiesenes Fachpersonal durchgeführt werden!

Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten dürfen ausschließlich durch die Firma Block Optic oder durch die Firma Block Optic autorisiertes und unterwiesenes Fachpersonal durchgeführt werden!

Selbst durchführbare Reparaturarbeiten finden Sie im Kapitel 6: Wartung, Reinigung, Pflege und Entsorgung.

Anschlussvoraussetzungen:

Der Netzanschluss 230 V des Instrumenten- und Gerätetischs und die Stromversorgung mit den elektrischen Verbrauchern auf dem *Exclusiv* erfolgt über den fest eingebauten Kaltgerätestecker. Der Netzschalter leuchtet beim Einschalten des *Exclusivs* dauerhaft, ist aber KEINE Anzeige für das korrekte Funktionieren der Steckdosen bzw. des Hubmotors.

Bei Problemen mit der Stromversorgung für die Tischgeräte bzw. des Hubmotors sind die entsprechenden Sicherungen zu prüfen.

Wichtig!

Es dürfen nur Sicherungen mit dem Wert T 4A für Hubmotor und Sicherungen T 2A für die Kaltgerätesteckdosen eingesetzt werden.

3 Verpackung

Der Instrumenten- und Gerätetisch *Exclusiv* kann bei Bedarf in einer speziellen Transportkiste angeliefert werden:

Abmessungen (L/B/H): variabel, abhängig von gewählter Ausstattung

Gewicht: variabel, abhängig von gewählter Ausstattung, min. 70 kg

Bitte prüfen Sie bei der Anlieferung die Verpackungskisten auf äußere Beschädigungen und beachten Sie die beiliegenden Frachthinweise!

Hinweis!

Bitte achten Sie auf die vollständige Entnahme aller zum Instrumenten- und Gerätetisch gehörenden Einzelteile!

Für das Aufstellen des Instrumenten- und Gerätetischs ist das Werkzeugsortiment eines Kundentechnikers ausreichend. Spezialwerkzeuge sind nicht erforderlich.

4 Gerätebeschreibung und Systemkomponenten

Exclusiv ist eine hochwertige Serie von höhenverstellbaren Instrumenten- und Gerätetischen aus dem Hause Block. Wahlweise können ein, zwei oder drei Geräte ergonomisch platziert und angeschlossen werden. Zusätzlich bietet *Exclusiv* Fläche für Schreib- und Computertätigkeiten. Optionale Unterbringungsmöglichkeiten für Computer, Drucker und Zubehör komplettieren den flexiblen Arbeitsplatz. Das integrierte Kabelführungssystem ermöglicht die Stromversorgung aller Geräte und verschiedene weitere Anschlussmöglichkeiten.

Der Instrumenten- und Gerätetisch *Exclusiv* besteht aus einer Anzahl von Systemkomponenten, die sinnvoll miteinander kombinierbar sind. Die Entwicklung und das Design des *Exclusiv* liegen in seiner optimalen Beschaffenheit als Instrumenten- und Gerätetisch in der Augenheilkunde. Er ist als Instrumenten- und Gerätetisch mit unterschiedlich großer Arbeitsplatte erhältlich. Die Tischplatte ist (optional) in verschiedenen Formen, Tischplattenstärken, Oberflächen und -größen verfügbar. Zusätzlich besteht der Instrumenten- und Gerätetisch *Exclusiv* aus folgende Zubehörteilen:

1. Beleuchtet Ein- und Ausschalter (grün);
2. Wippschalter für Höhenverstellung des Motors;
3. Hubmotor für Höhenverstellung (über Sicherung, 4 AT);
4. Vier Stellfüße (in der Höhe ca. 1 cm verstellbar) und
5. Vier Kaltgerätesteckdosen für Tischgeräte die separat abgesichert sind (2 AT) (geschaltet über Ein- und Ausschalter).

Optional erhältlich sind:

1. Leichtlauf-Rollen mit Bremsen;
2. Netzwerkdose für PC Verbindung;
3. Computerhalterung unter dem Tisch;
4. Containerunterbau zur Unterbringung von Kleingeräten wie PC, Drucker etc. (nicht in Verbindung mit Computerhalterung);
5. Monitorhalterung für einen Flachbildschirm;
6. Kleine Druckerablage zur Befestigung am schmalen Ende des Tisches;
7. Armauflage zur Befestigung am schmalen Ende des Tisches;
8. Schleppkette für Netzkabelführung und

9. Spezielle Block Kabeldurchführung um die installierten Tischgeräte mit Spannung aus dem *Exclusiv* zu versorgen.

Durch die optimale Ausnutzung der Tischoberfläche durch entsprechende Geräte sowie seine stufenlose Höhenanpassung ist eine schnelle und einfache Untersuchung möglich. Die Bedienelemente des *Exclusivs* befinden sich ergonomisch zugänglich auf der Untersucherseite.

5 Bedienung und Sicherheitsmaßnahmen

Bedienung:

Das Ausschalten des Tisches sowie die darauf installierten Tischgeräte (bei Spannungsversorgung über den *Exclusiv*) werden über den beleuchteten Hauptschalter getätigt. Die Veränderung der Tischhöhe wird sehr einfach über einen an der Bedienerseite liegenden Wippschalter ermöglicht.

Des weiteren verfügt der *Exclusiv* über vier bis sechs, je nach Ausstattung, Kaltgerätesteckdosen für die zu montieren Tischgeräte. Diese Steckdosen sind über eine 2,0 AT Sicherung abgesichert.

Sicherheitsmaßnahmen:

Achten Sie bei jeder Höhenverstellung darauf, dass der Patient keiner Gefährdung ausgesetzt wird.

6 Wartung, Reinigung, Pflege und Entsorgung

Zur Wartung und Pflege der installierten Untersuchungsgeräte/ Zulieferprodukte halten Sie sich bitte jeweils an die Gebrauchsanweisung des betreffenden Gerätes.

Selbst durchführbare Reparaturarbeiten:

Bei Sicherungswechsel den Hauptschalter ausschalten! Keine anderen Sicherungstypen und -stärken benutzen als die angegebenen! Informationen im technischen Anhang!

Wartung und Sicherheitstechnische Kontrolle (STK):

Um den hohen Sicherheitsstandard und die hohe Qualität des Instrumenten- und Gerätetisches *Exclusiv* zu erhalten, empfehlen wir, den Tisch einer regelmäßigen Wartung zu unterziehen. Wenden Sie sich hierzu an einen autorisierten Fa. Block Optic – Servicetechniker.

Für den Instrumenten- und Gerätetisch *Exclusiv* werden bis zu 10 Jahre nach Kaufdatum Ersatzteile bereitgehalten. Danach können Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten nur bedingt mit Originalteilen durchgeführt werden.

Folgende Wartungsarbeiten müssen jährlich durch autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden:

- Zustand aller außen liegenden Leitungen überprüfen (Prüfung auf Isolationsschäden),
- Generelle Prüfung auf korrekte Funktion,
- STK und MTK nach Medizinprodukte Gesetz.

Reinigung und Pflege:

Wichtig!

Bei der Reinigung des Instrumenten- und Gerätetisches mit angefeuchteten Putztüchern den Hauptschalter ausschalten! Vor Wiederinbetriebnahme Gerät vollständig abtrocknen lassen!

Die beschichteten Oberflächen mit einem sauberen, leicht angefeuchtetem Tuch abwischen. Verwenden Sie keine scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel! Dabei darf keine Feuchtigkeit in die Tastaturelemente eindringen. Die Abdeckung des Instrumenten- und Gerätetisches mit einer geeigneten Staubschutzhaube nach Arbeitsende ist wegen der montierten staubempfindlichen optischen Mess- und Untersuchungsgeräte ratsam.

Entsorgung:

Der Instrumenten- und Gerätetisch *Exclusiv* enthält Bauteile, die nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden können. Beauftragen Sie bitte für die Entsorgung ein Entsorgungsunternehmen.

7 Technische Daten

Stellfläche:	Instrumenten- und Gerätetisch 1: L/B: 1350 mm x 600 mm Instrumenten- und Gerätetisch 2: L/B: 1600 mm x 600 mm Instrumenten- und Gerätetisch 3: L/B: 1840 mm x 600 mm
Brutto-Gewicht:	abhängig von Ausstattung, min. 70 kg
Netzspannung:	230 V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	1500 VA zuzüglich aller angeschlossenen Außenverbraucher
Anschluss- -voraussetzung:	230 V / 50 Hz Kaltgerätesteckdose
Bedienungs- -bedingungen:	Umgebungstemperatur zwischen +10 °C bis +40 °C Relative Luftfeuchte zwischen 30 % und 75 % Luftdruck zwischen 700 hPa und 1060 hPa
Höhenverstellung des Tisches:	Nicht für Dauerbetrieb geeignet! Fortwährende Auf-/ Absteuerung darf 1,5 Minuten nicht übersteigen. Danach ist eine Abkühlphase von mindestens 8,5 Minuten notwendig.

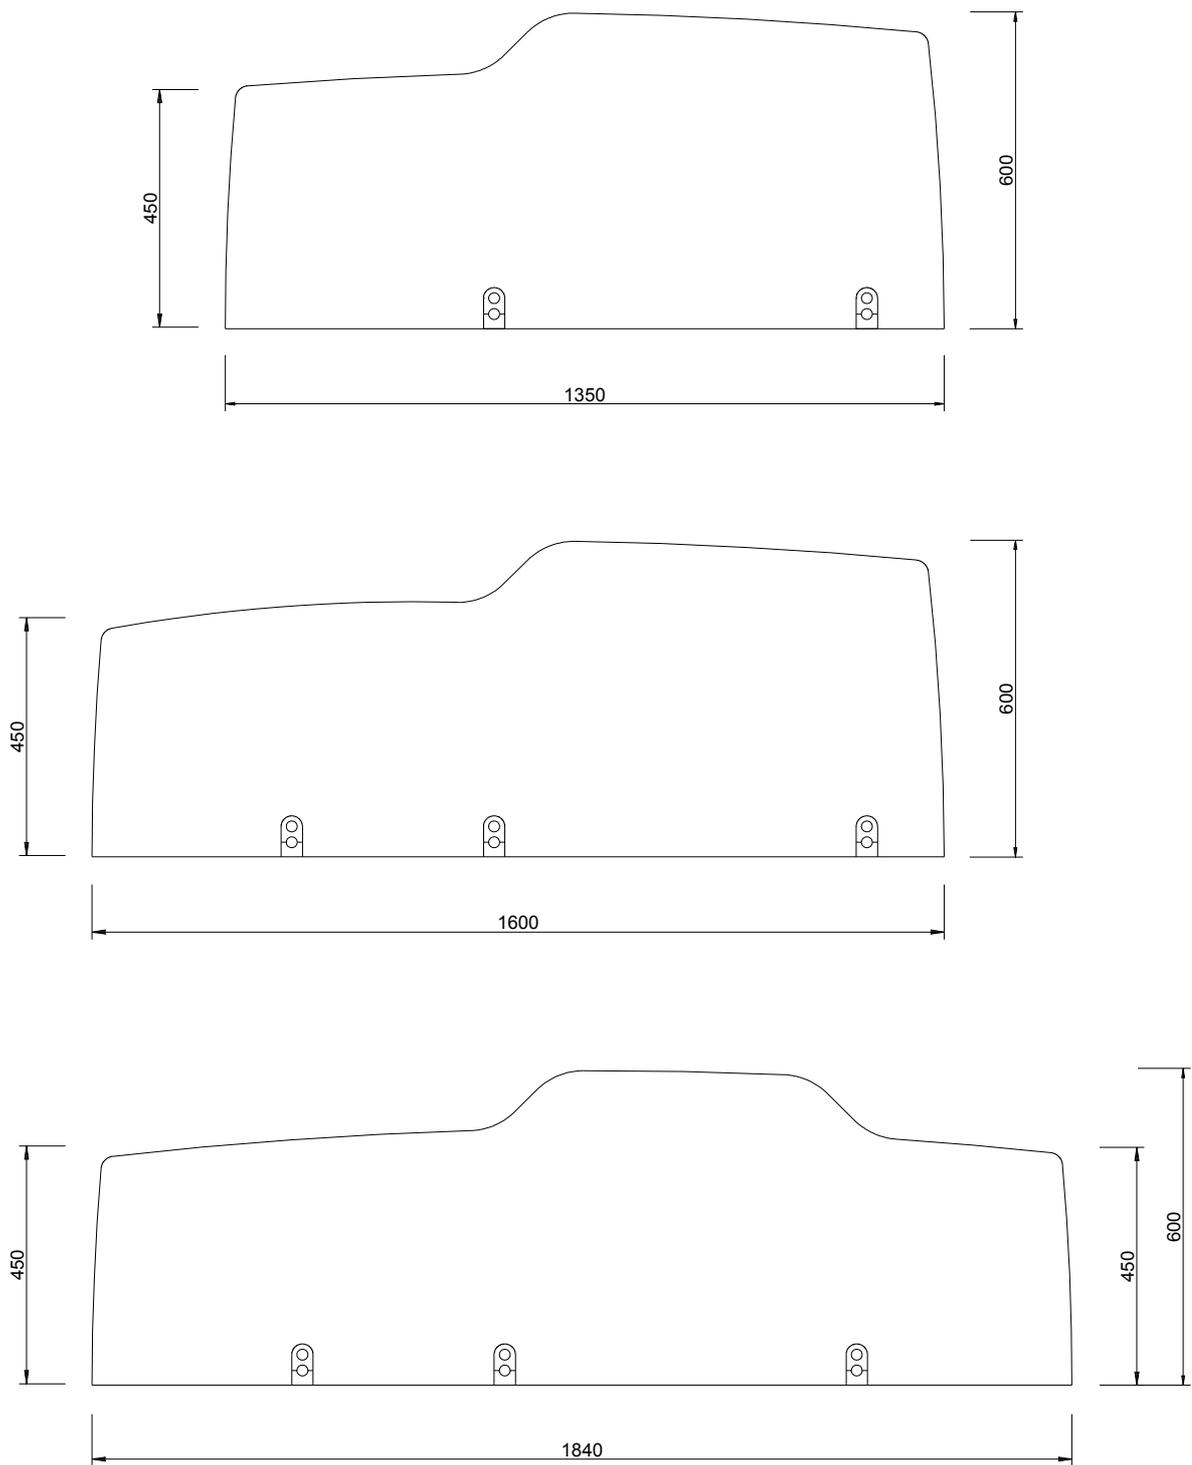


Abbildung 7.1: Abmessungen der Instrumenten- und Gerätetische Exclusiv

8 EG-Konformitätserklärung

Für die folgend bezeichneten Erzeugnisse der Firma Block Optic Ltd.:

Hubständer Modell Rondo und Exclusiv

wird hiermit bestätigt, dass sie den Anforderungen entsprechen, die in den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten festgelegt sind:

89/336/EWG elektromagnetische Verträglichkeit,
93/42/EWG Medizinprodukte.

Zur Beurteilung der Erzeugnisse wurden folgende Normen herangezogen:

EN 60601-1:2006 Medizinische elektrische Geräte,
EN 55011 Störaussendung,
IEC 801 Störfestigkeit.

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller:

Block Optic Ltd.
Semerteichstr. 60
44141 Dortmund
Deutschland

Diese Instrumententische sind gekennzeichnet mit:



Abgegeben durch:

J. Grawunder, Geschäftsführer

Dortmund, 1. Januar 2016

(Ort, Datum)



(rechtsgültige Unterschrift)